

Caractéristiques et spécifications techniques relatives aux modèles

Mod.

“PICASSO Quattro”

- 240022, 240022P, 240022R, 240022PR



“PICASSO Quattro Smart”

- 240022S, 240022SP, 240022SR, 240022SPR



CE FASCICULE EST PART DU MANUEL DE LA SECURITE' GENERALE DU PRODUIT

- **Plaque d 'identification**
- Déclaration de conformité
- Les commandes
- **Pièces de rechange** et intervention technique

OBBLIGATION DE LIRE AVANT LA PREMIERE UTILISATION DE LA TABLE

Ce manuel doit être conservé et tenu à portée de main pour être consulté chaque fois qu'il le sera nécessaire.

SOMMAIRE


I.	PLAQUE D'IDENTIFICATION	3
II.	CLASSIFICATION ET UTILISATION	4
III.	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	5
IV.	COMMANDES ET CONFIGURATIONS	6
V.	COMPOSANTS UTILISÉS	8
	INFO PRODUIT	9
	DECLARATION DE CONFORMITE' UE	10

I. PLAQUE D'IDENTIFICATION

ETIQUETTE - Explication

La plaque d'identification ci-dessous indique les données techniques ; elle est placée sur le châssis de l'appareil. Elle permet d'identifier le produit et d'en repérer les caractéristiques si des problèmes techniques surviennent ou si des pièces de rechange sont nécessaires. La plaque ne doit **JAMAIS** être enlevée, endommagée ou recouverte.

PLAQUE D'IDENTIFICATION

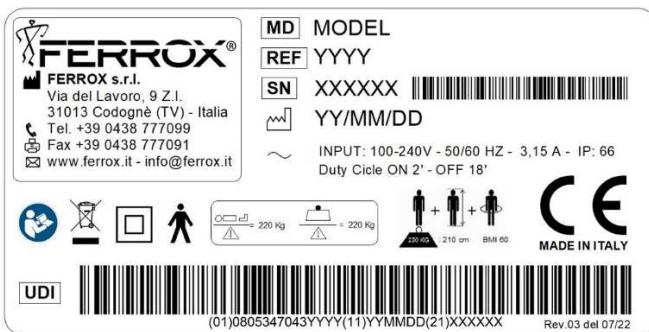

<i>Symboles/ Acronymes</i>	<i>Description</i>		<i>Symboles/ Acronymes</i>	<i>Description</i>
MD	Indique qu'il s'agit d'un dispositif médical			Symbole RAEE (Déchets d'Equipements Électriques, Électroniques et batteries)
REF	Identifiant catalogue			Dispositif en Classe II
SN	Numéro de série			Partie appliquée type B
	Identification du fabricant			- Poids maximum du patient. - Poids maximum de sécurité du lit
	Date de fabrication			- Poids maximum du patient - hauteur maximum - Indice de masse corporelle
	Produit alimenté par source de courant alternatif			- Attention aux éventuels écrasements de mains ou de membres en général
	Charge de travail en sécurité			Marque de conformité CE MDR 2017/745
	Consulter le mode d'emploi		UDI	Identification-Unique-des-Dispositifs-Médicaux
CH REP	Mandataire Suisse			

II. CLASSIFICATION ET UTILISATION

“Picasso Quattro”: Cod. 240022, 240022P, 240022R, 240022PR
“Picasso Quattro Smart”: 240022S, 240022SP, 240022SR, 240022SPR

- Partie appliquée : type B (IEC)
- Classe d'isolation électrique : II
- Degré de protection de la centrale et du vérin : IP66
- Charge de travail en sécurité : 140 kg
- Rembourrage et revêtement de type classe 1-IM

- Système d'interruption du courant : OUI
- Accumulateur Tampon (*) : NON

Utilisation : La table est particulièrement adaptée à l'utilisation dans le contexte de la réhabilitation et de la kinésithérapie mais elle est aussi utilisable dans d'autres milieux professionnels. La table doit être installée suivant les données EMC indiquées ci de-suite :

! Ne pas se servir du produit de manière différente à son utilisation prévue.

! Signaler tout incident grave survenant à cause du dispositif. Le signalement devra être effectué auprès du fabricant et de l'autorité compétente.

Un accumulateur tampon *(1) **n'étant pas** installé, la table n'est pas utilisable dans les hôpitaux où dans les milieux où il pourrait être nécessaire d'effectuer des mouvements rapides même en absence ou d'interruption de courant de réseau.

La table est cependant utilisable dans des milieux très fréquentés, même en présence de mineurs, car **elle est** équipée d'un système d'interdiction du courant.

La fonction **Trendelenburg** **n'est pas présente** sur toutes les versions ci-dessus indiquées.

Minutage du moteur électrique : 2 minutes d'utilisation toutes les 18 minutes de pause.




***(1)** l'accumulateur tampon est un accessoire applicable à l'origine, et sur demande, que par le constructeur.


Les tables FERROX sont classifiées en tant que dispositif médical en classe 1, conformément aux indications de règlement (UE) 2017/745 du Parlement Européen et du Conseil du 5 avril 2017.

III. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions **code : 240022**



code : 240022S





Hauteur : **variable 48>90 cm**



Diamètre roues : **60 mm**

Gamme : FERROX STUDIO PICASSO		MODÈLE:	
		“Picasso Quattro”	“Picasso Quattro Smart”
PICASSO Quattro	240022	240022S	
PICASSO Quattro avec cadre de commande	240022P	240022SP	
PICASSO Quattro avec roulettes	240022R	240022SR	
PICASSO Quattro avec cadre de commande et roulettes	240022PR	240022SPR	
Massé moyenne		Kg.100	
Charge de travail en sécurité		Kg.140	
Charge de travail maximale		Kg.180	
Moteur (Vérin)		Électrique	
Tension et fréquence		100V-240V - Fréquence 50/60hz	
Courant max		1,5 A	
Fonction intermittente		2 min. actives 18 min. passives	
Force de poussée		8000N pour élévation	
Durée de vie prévue : 10 ans (estimation de la période pendant laquelle le dispositif pourra être utilisé).			

IV. COMMANDES ET CONFIGURATIONS

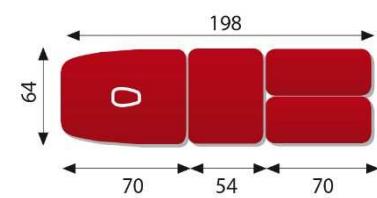

1 - 240022, 240022R, 240022S, 240022SR
RÉGLAGE DE LA HAUTEUR
COMMANDÉ PAR POIGNÉE

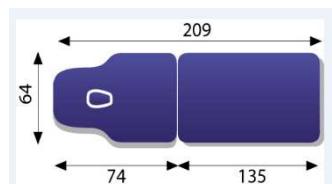

1A - 240022P, 240022PR, 240022SP, 240022SPR
RÉGLAGE DE LA HAUTEUR
PAR CADRE DE COMMANDE

2 RÉGLAGE DE LA TÊTEIÈRE
LEVIER DE COMMANDE DU VÉRIN À GAZ

3 RÉGLAGE DU DOSSIER ET DES JAMBIES

A) RÉGLAGE HAUTEUR PAR COMMANDE À MAIN

Allumage du voyant vert

- Pour activer: appuyer sur la clé de gauche à droite.
- Pour désactiver: tirer la clé vers l'extérieur



B) TABLES AVEC PÉDALE DE COMMANDE OU CADRE DE COMMANDE

Circuit activé (en marche)



En position **ON** (I) circuit ouvert (table en fonctionnement)

Circuit désactivé (en sécurité)



En position **OFF** (0) circuit fermé (pas de fonctionnement)

IL EST IMPERATIF de désactiver la fonction de marche ET d'emporter la clé (fixée à la commande à main), ou la clé magnétique, alors que la table n'est pas en utilisation.

JAMAIS laisser la table sans la surveillance de l'utilisateur (ou du praticien) alors que le patient y est installé.


* RÉGLAGE DE LA HAUTEUR:

1 - REF 240022, 240022R, 240022S, 240022SR

AVEC LE BOÎTIER DE COMMANDE À MAIN ACTIVÉ:

Appuyer sur (1) jusqu'à ce que la table médicalisée atteigne sa hauteur **maximale** ou la hauteur intermédiaire souhaitée.

Appuyer sur (2) jusqu'à ce que la table médicalisée atteigne sa hauteur **minimale** ou la hauteur intermédiaire souhaitée.



- REF : 240022P, 240022PR, 240022SP, 240022SPR



1A


Cadre de commande, option pour toutes les tables de massages et traitements.
En utilisant le cou du pieds, déplacer le cadre de commande vers la gauche ou vers la droite pour lever ou baisser la table.

*** RÉGLAGE DE L'INCLINAISON DU DOSSIER**

Levier de commande du vérin à gaz



2




Pour commander l'ouverture du vérin à gaz, pousser vers le haut le levier de commande placé sous la section correspondante de la table. Monter ou baisser la section concernée jusqu'à ce que l'inclinaison souhaitée soit atteinte.

Relâcher le levier progressivement pour obtenir l'inclinaison souhaitée.

Le déclenchement soudain bloquera immédiatement la section.

3



*** RÉGLAGE DE L'INCLINAISON DES JAMBIERS**

Levier de commande du vérin à gaz



Relâcher le levier progressivement pour obtenir l'inclinaison souhaitée.

Un déclenchement soudain bloquera immédiatement la section.

NOTE POUR TOUTES FONCTIONS D'UTILISATION DU VERIN A' GAZ :



N.B. Pour prévenir **d'éventuelles** blessures du thérapeute ou du patient, retenir et incliner la section concernée de la table avec une main, **avant** d'activer le levier pour le réglage de l'inclinaison à vérin à gaz. Cela évitera que la section ne ressorte dans sa position initiale.

ROULETTES : Lorsque les roulettes sont présentes, actionner le levier de commande jusqu'à ce que la table médicalisée repose fermement sur le plancher. Les roulettes sont uniquement destinées à être utilisées pour déplacer la table. La table ne doit **jamais** être laissée installée avec les roulettes abaissées.

Levier de commande des roulettes

Soulever ou abaisser les roues en utilisant le levier de commande



V. COMPOSANTS UTILISÉS

** PIÈCES DE RECHANGE S.A.V.

Les éléments électroniques

	Pour l'élévation T5EM005 ** VERIN ELECTRIQUE TA7 8000 N IP66	art. TA7-4115-002	nr. lotto xxxx
	T1EM002 ** Boîtier d'alimentation TP9, sortie 29VDC IP66	art. TP9-4115-001	nr. lotto xxxx
	T3EM002 ** Boîtier de control TC14 24VDC 4 sortie IP66	art. TC14-4115-002	nr. lotto xxxx
	T4EM007 ** COMMANDE A 'MAIN'	art. TH12-4115-003	nr. lotto xxxx
	T4EM001 **Commande pour cadre	art. TES-2300-001	nr. lotto xxxx
	C3EM0181 COMMANDÉ COUPE CIRCUIT A' CLE'		nr. lotto xxxx

Vérins à gaz:

C3PI0230 ** VÉRIN À GAZ 500 N	art. 756625	nr. lotxxxxxxxx
C3PI0231 ** VÉRIN À GAZ 800 N	art. 756724	nr. lotxxxxxxxx
C3PI0308 ** LEVIER DE COMMANDE VERIN	art. LMTONBB000	nr. Lotxxxxxxxx
C3PI0320 ** CABLE DE COMMANDE DU VERIN	art. T1186009	nr. Lotxxxxxxxx
C3PI0315 ** CABLE DE COMMANDE DU VERIN	art. T1186004	nr. Lotxxxxxxxx
C3PI0321 ** PROTECTION ET LEVIER	art. CMGTA002B	nr. lotxxxxxxxx

Roulettes :

C3RU0982 **

**** Code de référence des pièces de rechange disponibles**

INFO PRODUIT

ÉTIQUETTE PRODUIT

DECLARATION DE CONFORMITE' UE

MDR 2017/745



CH REP

Device & Care Sagi – CHE456306571
Via Mulino 3, 6855 Stabio SWITZERLAND
TEL.: +41 762642520 – EMAIL: info@deviceandcare.com

Le fabricant :

FERROX S.r.l.

Via del Lavoro, 9 Z. I. – 31013 Codogné (TV) - ITALIA

+39 0438 777099 – +39 0438 777091

C. F. - P. IVA - R. I. IT 03613220262

info@ferrox.it

SRN: IT-MF-000011243

Déclare sous sa propre et complète responsabilité que les produits

Dénomination	Code	Identifié par UDI-BASIC:
Table PICASSO QUATTRO	240022	805347043PICASSOKM
Table PICASSO QUATTRO avec cadre de commande	240022P	805347043PICASSOKM
Table PICASSO QUATTRO avec cadre de commande et roulettes	240022PR	805347043PICASSOKM
Table PICASSO QUATTRO avec roulettes	240022R	805347043PICASSOKM
Table PICASSO QUATTRO SMART	240022S	805347043PICASSOKM
Table PICASSO QUATTRO SMART avec cadre de commande	240022SP	805347043PICASSOKM
Table PICASSO QUATTRO SMART avec cadre de commande et roulettes	240022SPR	805347043PICASSOKM
Table PICASSO QUATTRO SMART avec roulettes	240022SR	805347043PICASSOKM

Les produits répondent aux exigences générales de sécurité et de prestation prévues par l'Annexe I et aux prescriptions du RÈGLEMENT (UE) 2017/745 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 avril 2017.

L'entreprise déclare par ailleurs que les produits indiqués dans la présente déclaration de conformité sont:

- En conformité avec la Directive 2011/65/UE (Restriction of Hazardous Substances), sur la restriction d'utilisation de substances dangereuses dans les appareillages électriques et électroniques, comprenant les dispositions de la Directive Délégée (UE) 2015/863 promulguée par la Commission Européenne.

Classification (Annexé VIII, MDR 2017/745) :

Classe I (Règle1)

Procédure d'évaluation de la Conformité

Documentation technique ainsi qu'il est reporté aux annexés II et III.

Lieu, date : 08/01/2024

Le responsable

FERROX s.r.l.

Signature:

FERROX®

Physiotherapy Quality Solutions



Management
System
ISO 13485:2016
ISO 9001:2015
www.tuv.com
O 98086946



Stabilimento e sede legale:
via del Lavoro Z.I.
31013 Codogné (TV) Italia
Tel. +39 0438 777099 - 778370
Fax +39 0438 777091
P.IVA: IT 03613220262

e-mail: info@ferrox.it
www.ferrox.it